

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、検査の内容を変更させていただくことになりましたので
ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しく願い申し上げます。

敬具

(記)

【項目名】：リンパ球幼若化検査(分離培養法)Con-A
リンパ球幼若化検査(分離培養法)PHA

【変更日】：2019年4月1日(月)受付分より


【変更内容】

コード	検査項目名	変更箇所	(新)	(現行)
1726	リンパ球幼若化検査 (分離培養法)Con-A	基準値	Con-A刺激培養：なし SI(Con-A)：38.1~385.5 無刺激培養：なし	Con-A刺激培養：同左 SI(Con-A)：74.7~1793.2 無刺激培養：同左
884	リンパ球幼若化検査 (分離培養法)PHA	基準値	PHA刺激培養：なし SI(PHA)：147.5~1251.3 無刺激培養：なし	PHA刺激培養：同左 SI(PHA)：101.6~2643.8 無刺激培養：同左

【変更理由】

測定精度の向上を期し、測定機器を変更させていただきます。
なお、この変更に伴い、基準値を変更させていただきます。

リンパ球幼若化検査(分離培養法)Con-A

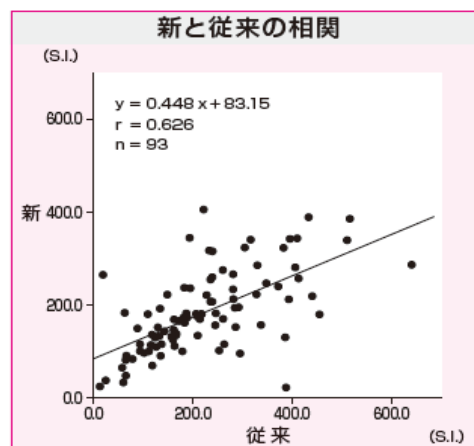

リンパ球幼若化・PHA(微量全血培養法)

