

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、検査の内容を変更させていただくことになりましたので
ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

(記)

【項目名】： 特異的IgE ヒノキ
Viewアレルギー39(ヒノキ)

【変更日】： 平成30年10月1日(月)受付分より

【変更内容】

コード	検査項目名	変更箇所	(新)	(現行)
1233	特異的 I g E ヒノキ	試薬	同一試薬製造元の改良試薬	従来試薬
3239	Viewアレルギー39(ヒノキ)	試薬	同一試薬製造元の改良試薬	従来試薬

【変更理由】

測定試薬を、特異性が向上した改良試薬に変更させていただきます。
この変更に伴う検査方法、報告単位等の変更はございません。

※新試薬と従来試薬との相関については、裏面をご参照ください。


【新試薬と従来試薬の相関図】

●特異的IgE ヒノキ

一致率表

		従来(クラス)							合計
		0	1	2	3	4	5	6	
新(クラス)	6						2		2
	5					7	3		10
	4				11	7			18
	3			11	15				26
	2		7	15					22
	1	2	4						6
	0	26	2						28
	合計	28	13	26	26	14	5	0	112

陽性一致率 100.0%
陰性一致率 92.9%
判定一致率 90.2%

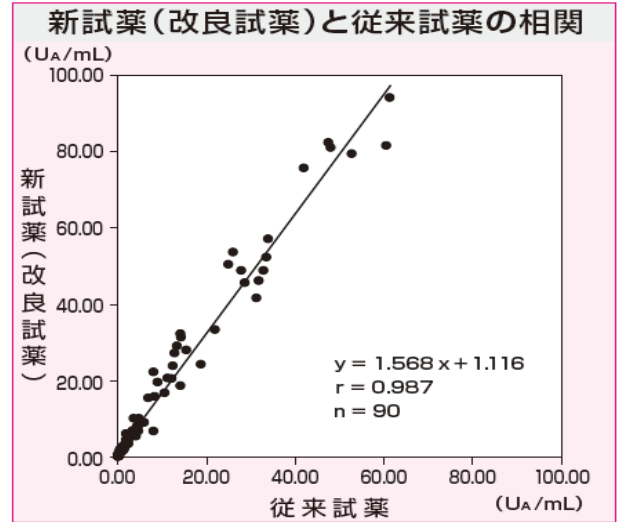


(BML 検討資料)

●View アレルギー-39(ヒノキ)

一致率表

		従来(クラス)							合計
		0	1	2	3	4	5	6	
新(クラス)	6						2	1	3
	5					4	3		7
	4				5	11			16
	3			8	14				22
	2		3	16	1				20
	1	4	3						7
	0	21	3	1					25
	合計	25	9	25	20	15	5	1	100

陽性一致率 98.5%
陰性一致率 84.0%
判定一致率 89.0%

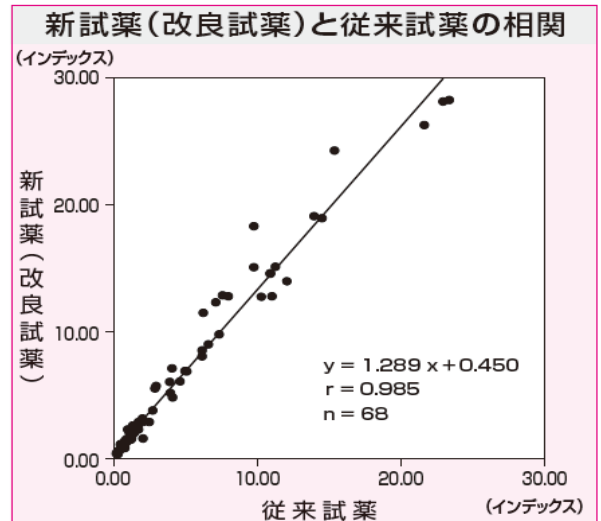

(BML 検討資料)